

*Perfectha*<sup>®</sup> 

qualité  
naturel  
efficace



# Notre Histoire

Le Laboratoire ObvieLine, créé en 2005, est spécialisé dans la recherche, le développement, la fabrication et la distribution de produits de comblement de rides à base d'acide hyaluronique.

Les produits sont strictement contrôlés par le Laboratoire ObvieLine avant d'être mis en vente.

Depuis 2005, le Laboratoire ObvieLine a développé un produit efficace et s'est imposé sur le marché de l'esthétique parmi les leaders.

Le Laboratoire ObvieLine obtient le marquage CE pour 3 produits intradermiques en 2007 (Perfectha® FineLines, Perfectha® Derm, Perfectha® Deep), en 2010 pour son volumateur (Perfectha® SubSkin) et en 2013 Perfectha® SubSkin 3x1mL et son produit d'hydratation (Perfectha® Complement).





# Technologie & Satisfaction


Le Laboratoire ObvieLine sélectionne les matières premières et composants optimum du marché afin d'obtenir un produit efficace et pratique pour les professionnels et de permettre une expérience confortable lors du traitement pour les patients.

Le Laboratoire ObvieLine utilise des matériaux robustes et durables pour améliorer la prise en main et la facilité d'application pour le spécialiste. Le système Luer Lock assure la sécurité et le maintien des aiguilles et canules en cours d'injection. Le backstop s'adapte parfaitement à la main du médecin pour une manipulation ergonomique et sécurisée du dispositif ; permettant une liberté de mouvement de la main du praticien, nécessaire pour certaines techniques d'injection (serial puncture, nappage).

La tige de piston a été spécialement conçue pour résister aux forces d'injection verticale (pouce) et latérale (paume) pour laisser aux médecins le choix de leur mode d'injection. Son poussoir est dimensionné pour le confort des praticiens qui sont amenés à réaliser de nombreuses injections.

TSK a mis au point un diamètre interne des canules mousses et des aiguilles agrandi, ce qui diminue de 35 % la force nécessaire pour l'extrusion et permet donc d'obtenir une injection plus souple et mieux contrôlée. La canule à orifice latéral découpé au laser, d'une souplesse optimale diminue le risque de saignement. Le conditionnement sous forme de capsule améliore la sécurité et la facilité de fixation de la seringue.

Tous les volets ont été analysés en termes de sûreté et sécurité de l'application, en tenant compte de l'avis des médecins et en intégrant la recherche permanente de nos ingénieurs ; il en résulte un dispositif médical adapté aux injecteurs, fabriqué selon les normes de production les plus strictes.

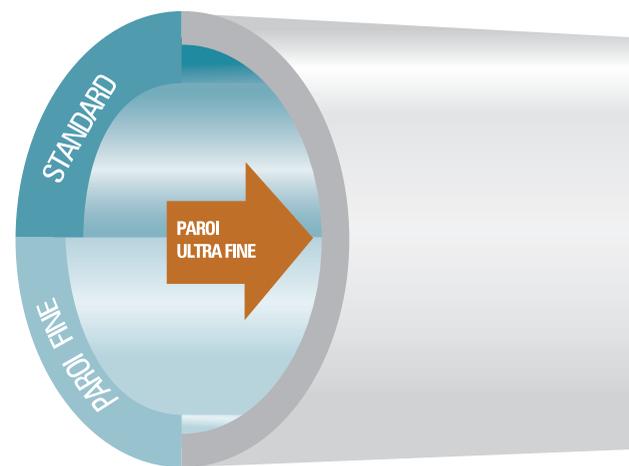

# Technologie E-Brid™

La technologie E-Brid™ est un procédé de réticulation unique, qui permet de créer des liaisons covalentes au coeur des particules d'acide hyaluronique et entre ces dernières.

Ce processus a été développé pour créer un gel hybride capable de répondre aux caractéristiques d'un implant à base d'acide hyaluronique efficace.



## Avantages d'un gel E-Brid™

### 1 UN PRODUIT DURABLE

Avec un traitement Perfectha®, les **résultats sont immédiatement visibles** et durent dans le temps, en raison de sa dégradation iso-volumique lente et uniforme.

L'implant Perfectha®, de part ses particules, absorbe plus facilement l'eau dans le corps qu'un autre implant. Cette caractéristique permet à l'implant de durer dans le temps.

### 2 PEU DE VOLUME POUR UNE FORTE CAPACITÉ DE COMPLEMENT

L'élasticité donne au gel la capacité de retrouver son aspect initial après une déformation. Plus le niveau d'élasticité est élevé, plus l'implant pourra retrouver son aspect initial après être passé au travers de l'aiguille.

Les implants Perfectha® ont la capacité d'absorber l'eau dans le corps et de croître. Cela permet aux médecins d'**utiliser peu de volume de gel pour obtenir un effet liftant optimal.**


### 3 UN PRODUIT FACILE À INJECTER

Une faible viscosité donne la capacité à l'implant de passer facilement au travers de la seringue. Le praticien a besoin d'utiliser moins de force lors de l'injection du gel sous la peau.

Les implants Perfectha® sont **facilement injectables** du fait de la **haute qualité des matières premières**, précieusement choisies par le Laboratoire ObvieLine, et du processus de fabrication du **gel E-Brid™**.

Le graphique est issu de l'étude clinique "EVALUATION OF THE INJECTION PROFILE OF THE JUVÉDERM® ULTRA RANGE WITH 3rd GENERATION PROPRIETARY NEEDLES" (réalisée à 13 mm/min) et de l'étude Tests de poussée réalisée pour Le Laboratoire ObvieLine (à 10 mm/min).

Force d'injection réduite de 50 à 80% avec les produits Perfectha®

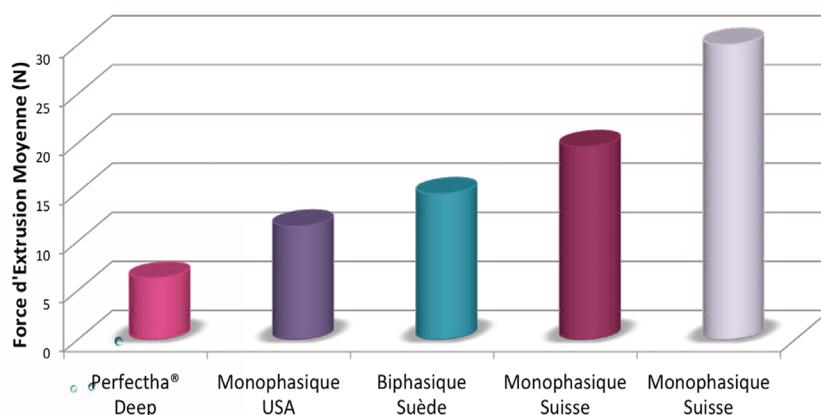

### 4 PRODUIT HYDRATANT

La technologie E-Brid™ a été développée de manière à obtenir 90% d'acide hyaluronique (AH) réticulé et 10% non réticulé. **Ce sont ces 10% d'acide hyaluronique non réticulé qui permettent la réhydratation de la peau.** Les 90% d'acide hyaluronique réticulés permettent de stopper la hyaluronidase détruisant l'acide hyaluronique.



# Perfectha®

## Efficacité & Satisfaction


### Efficacité

Les études menées sur les produits Perfectha® démontrent l'efficacité de la gamme ainsi que la résistance de l'implant face à la dégradation iso-volumique.

**Même après 180 jours**, les effets de comblement de Perfectha® perdurent comme le démontre ce graphique.

Référence: "Evaluation de l'innocuité et de l'efficacité d'un nouveau produit de comblement à base d'acide hyaluronique pour le traitement des sillons nasogéniens et du contour des lèvres; Surg. Cosmet. Dermatol.2010;2(2):83-6"

Efficacité de Perfectha® pour les sillons nasogéniens et le contour des lèvres

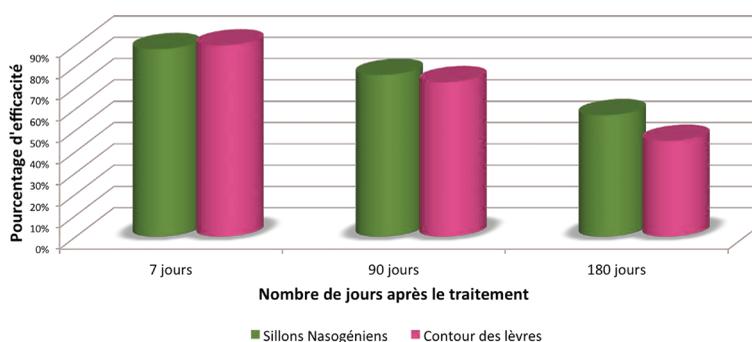


### Satisfaction






Les études ont également montré la haute satisfaction, après une séance d'injection, aussi bien des médecins que des patients selon des critères prédéfinis, **jusqu'à 12 mois**.

Référence: "Une étude prospective de l'évaluation des résultats obtenus avec l'application de Perfectha® SubSkin, un nouveau gel d'acide hyaluronique d'origine non animale pour l'amélioration de la région malaire" Dr Farès J., Regazzini D.

Résultats d'efficacité après un traitement avec Perfectha®

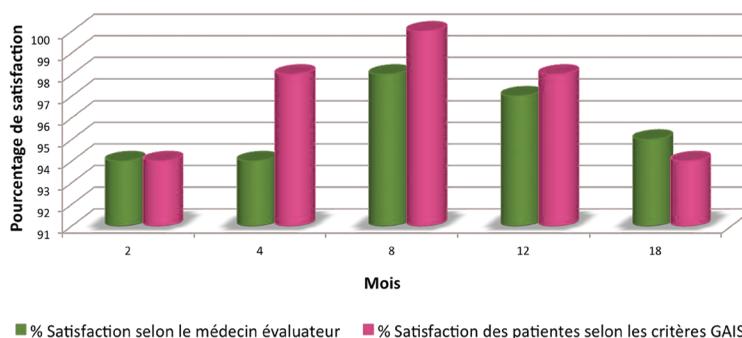

# Avant & Après

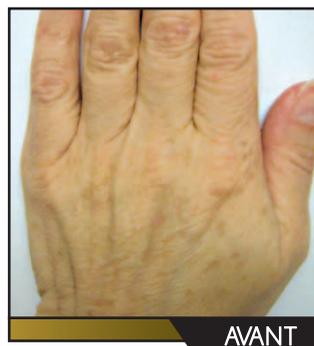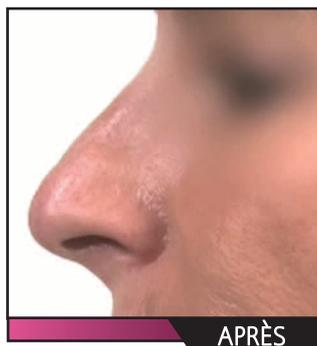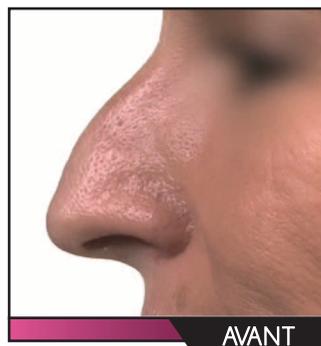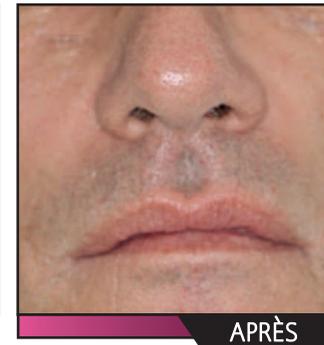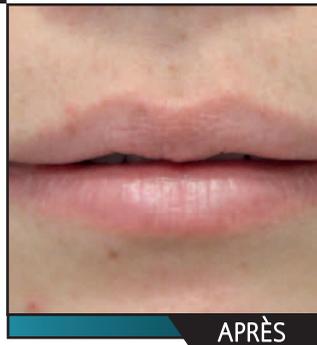

# Chaque produit a été créé pour répondre à vos besoins

Perfectha® est un acide hyaluronique d'origine non animale, obtenu par fermentation bactériennes biotechnologiquement modifié. Hautement compatible; pH compris entre 6.5 et 7.5, exempt de bactéries aérobies et anaérobies et de spores fongiques; taux d'endotoxines très faibles.




## Perfectha® FineLines

1 Seringue de 0.5ml avec Deux Aiguilles 30G x 1/2  
Pour traiter les rides fines et Les ridules superficielles (application dans le derme superficiel)  
180,000 particules / mL de gel  
20 mg/mL d'acide hyaluronique

### Parfait pour:

- Effacer Les lignes périorbitaires
- Reduire les cernes
- Effacer Les lignes péribuccales

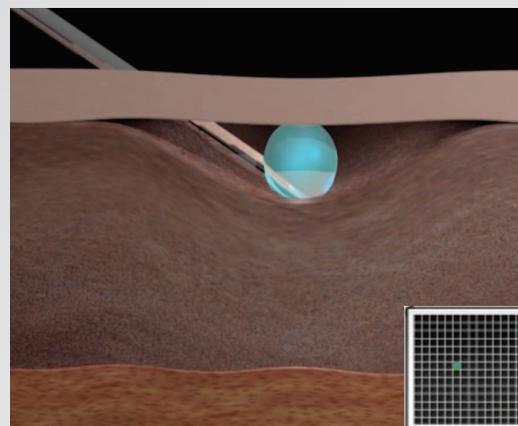


## Perfectha® Derm

1 Seringue de 1.0ml avec Deux Aiguilles 30G x 1/2  
Pour des corrections modérées au niveau du visage et du contour des lèvres (application dans le derme moyen)  
90,000 particules / mL de gel  
20 mg/mL d'acide hyaluronique

### Parfait pour:

- Effacer la ride du lion
- Redéfinir le contour des lèvres
- Effacer les commissures buccales

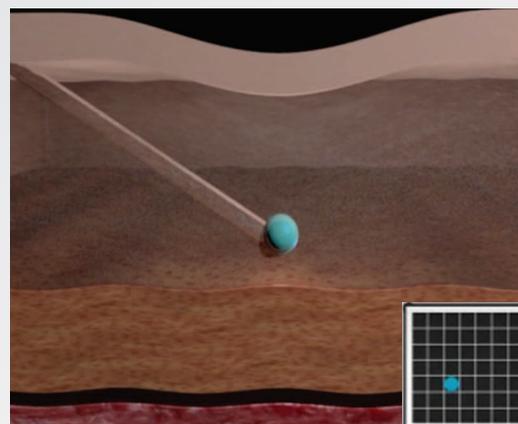




## Perfectha® Deep

1 Seringue de 1.0ml avec Deux Aiguilles 27G x 1/2  
Pour traiter les rides profondes, les sillons et  
augmenter le volume des lèvres (application dans le  
profond)

8,000 particules / mL de gel  
20 mg/ml d'acide hyaluronique

### Parfait pour:

- Corriger les sillons nasogéniens
- Augmenter le volume des lèvres
- Redéfinir les contours du nez

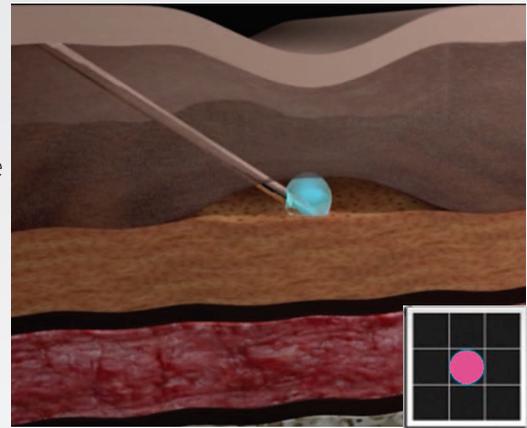


## Perfectha® SubSkin

1 Seringue de 3.0ml ou 3 Seringues de 1.0ml avec  
Canule + Aiguille 22G ou Canule + Aiguille 21G  
Pour remodeler le volume de la mâchoire, du  
menton, des joues et des mains (application  
sous-cutanée)

2,000 particules / mL de gel  
20 mg/ml d'acide hyaluronique

### Parfait pour:

- Redéfinir les contours du visage
- Augmentation des joues et du menton
- Rajeunissement des mains

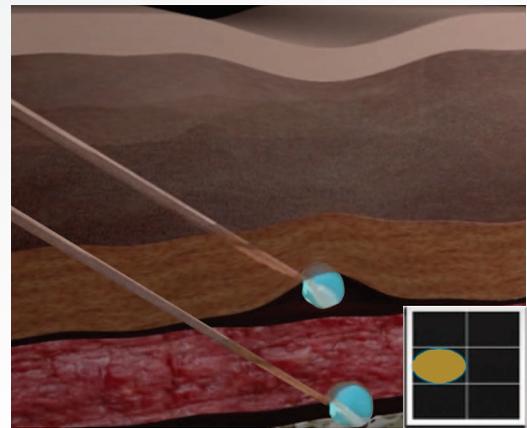


## Perfectha® Complement

1 Seringue de 0.8ml avec Deux Aiguilles 30G x 1/2  
Pour des retouches après un traitement au botox  
ou un peeling (application dans le derme superficiel)

180,000 particules / mL de gel  
20 mg/ml d'acide hyaluronique

### Parfait pour:

- Réhydratation
- Retouches
- Combinaison avec des produits de Mésothérapie

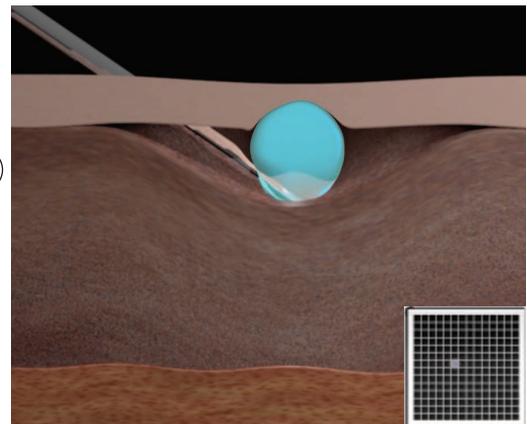

# Perfectha® dans le monde




Perfectha® figure parmi les leaders du marché et est présent dans plus de 70 pays à travers le monde.

Les produits Perfectha® sont des dispositifs médicaux réglementés qui portent, au titre de cette réglementation, le marquage CE.  
Se reporter aux indications de la notice et de l'étiquetage avant toute utilisation.

# Perfectha® une gamme complète pour:

- Un effet lifté optimal avec peu de volume injecté
- Une durée maximale de l'implant
- Une facilité d'injection pour les médecins
- Une peau hydratée

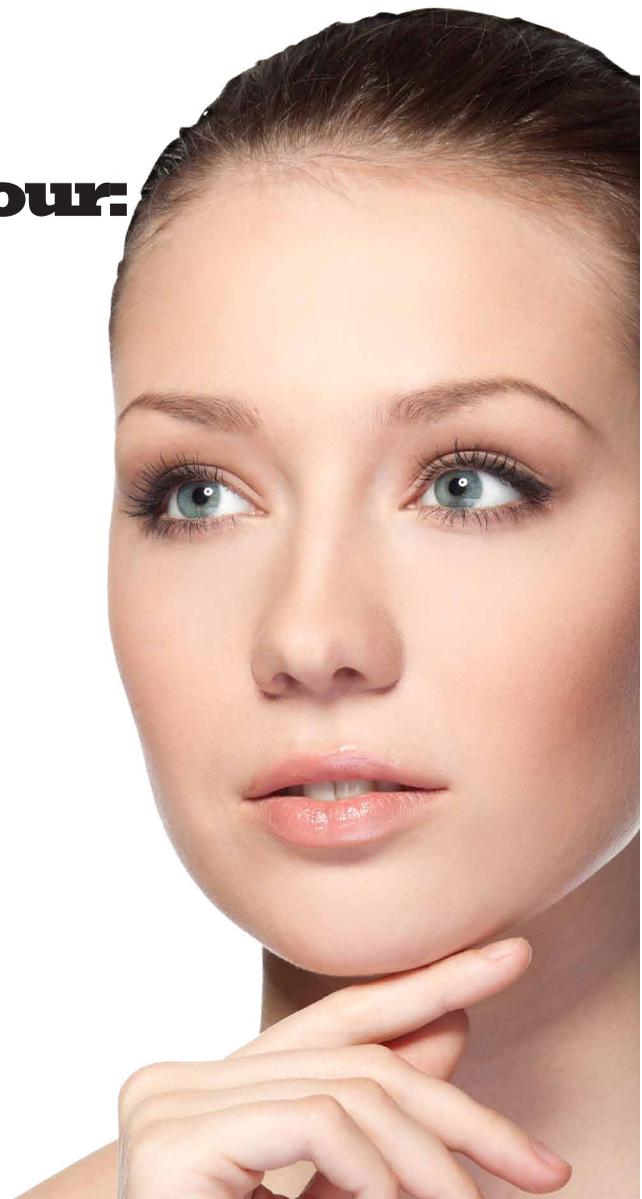

Comme tout dispositif médical de comblement à base d'acide hyaluronique, les produits Perfectha® peuvent avoir des effets indésirables consécutifs au traitement comme érythème, oedème, induration, nodule et granulôme. Ces réactions doivent faire l'objet d'un signalement auprès des fabricants et des autorités compétentes de votre pays.



LABORATOIRE  
**ObvieLine**  
FRANCE

8, chemin du Jubin - 69570 Dardilly, France  
Tel. +33 (0) 472 520 760 | Fax. +33 (0) 472 529 249  
[www.obvieline.com](http://www.obvieline.com)

